

Připraveno

Test

Pohlaví

Mužské

Věk

40

Datum narození

01/01/1986

Přehled záznamů EKG

Záznam pořízen:

středa 15. čvc 2026 11:39 dop.

Tepová frekvence:

73 TEPŮ/MIN.

Doba trvání:

30s

Detekce Kardia


Normální sinusový rytmus* Detekce Kardia na svodu I provedena.

Poznámky


Žádné další informace k zobrazení

Zařízení Kardia nekontroluje srdeční infarkt. Pokud se domníváte, že potřebujete pomoc lékaře, zavolejte záchrannou službu. Společnost AliveCor neposkytuje lékařské rady ani služby a veškeré informace jsou společností AliveCor poskytovány pouze jako pomoc vám a vašemu lékaři při lékařské péči a nenahrazují konzultaci s lékařem.


Rozšířený filtr, Síťový filtr: 50 Hz Stupnice: 25mm/s, 10mm/mV

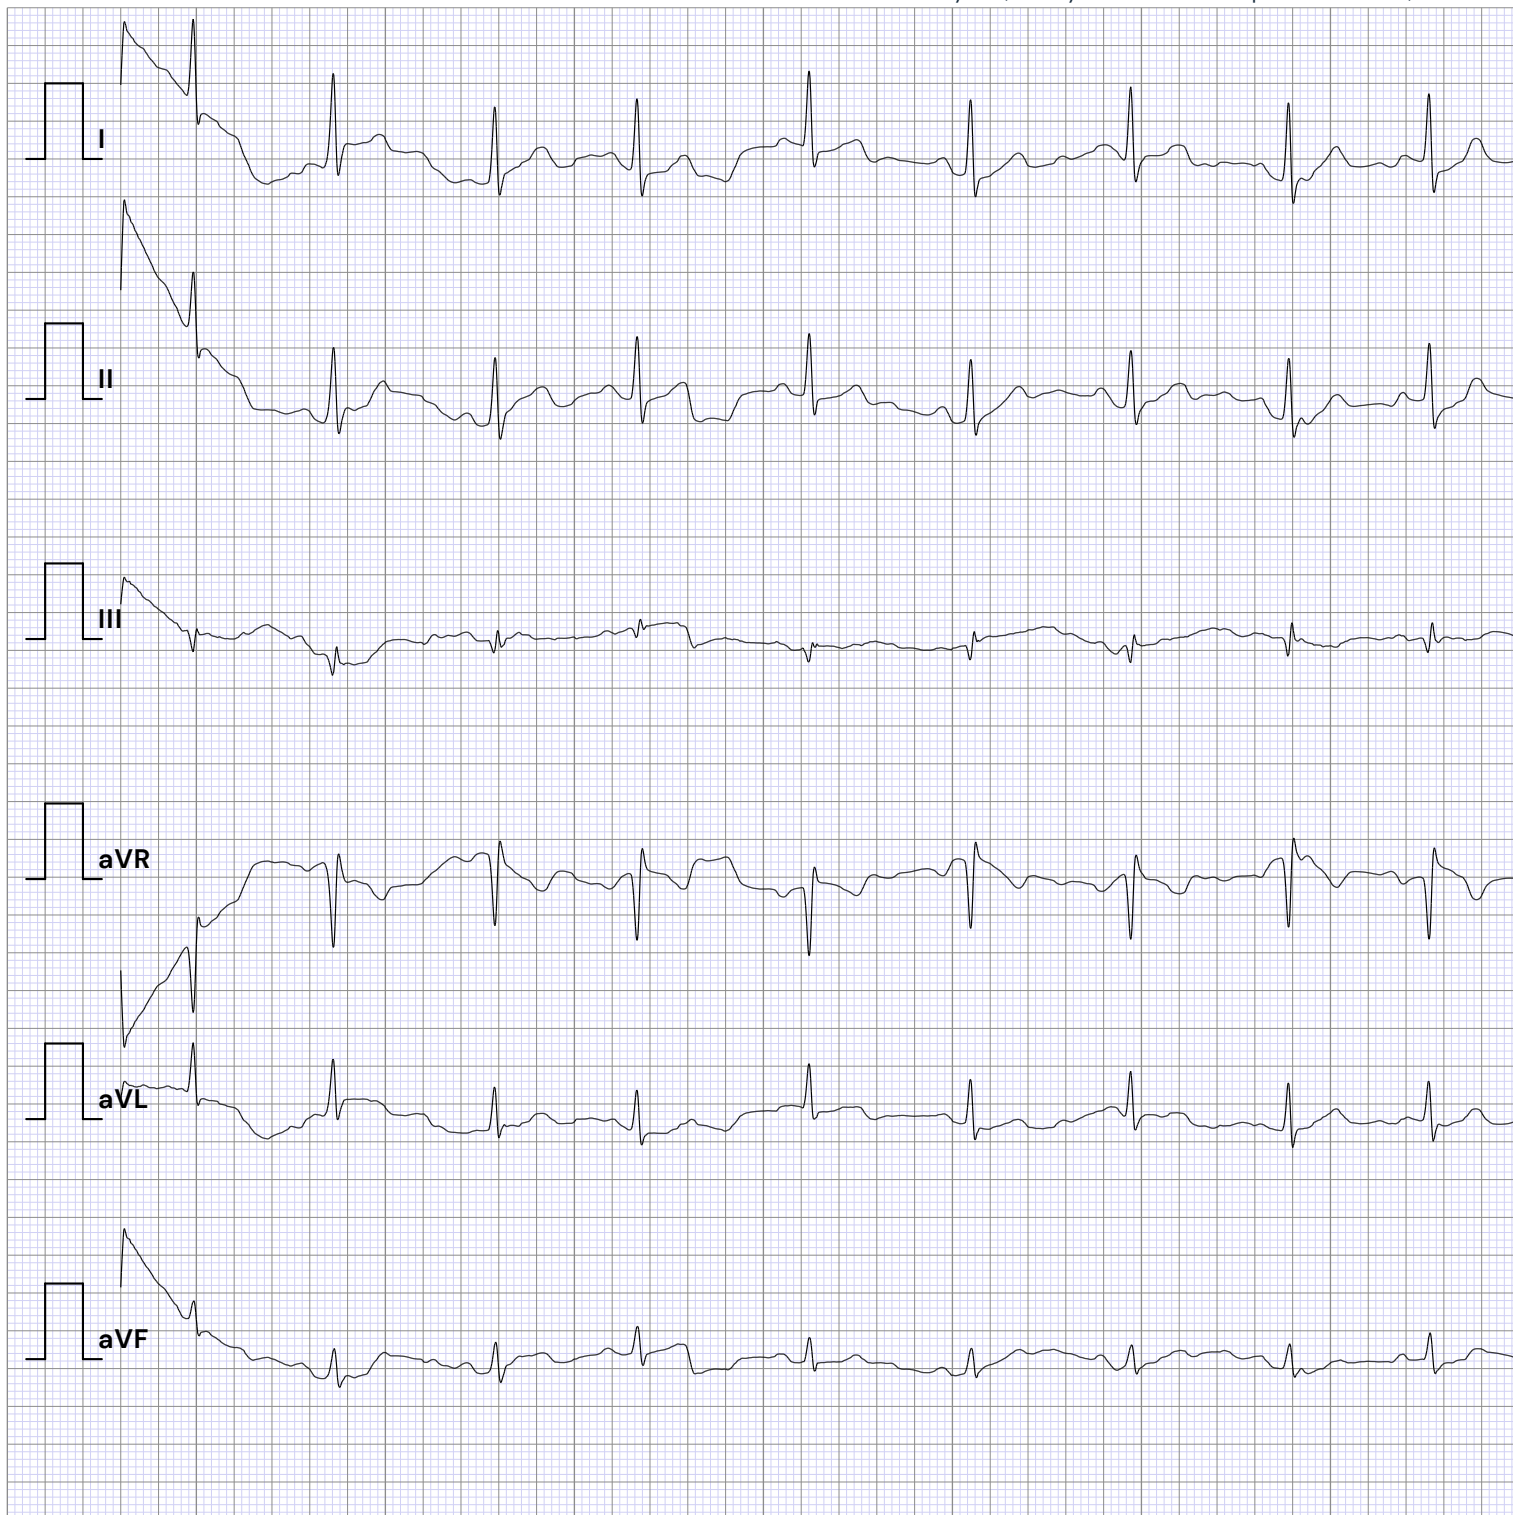

Rozšířený filtr, Síťový filtr: 50 Hz Stupnice: 25mm/s, 10mm/mV

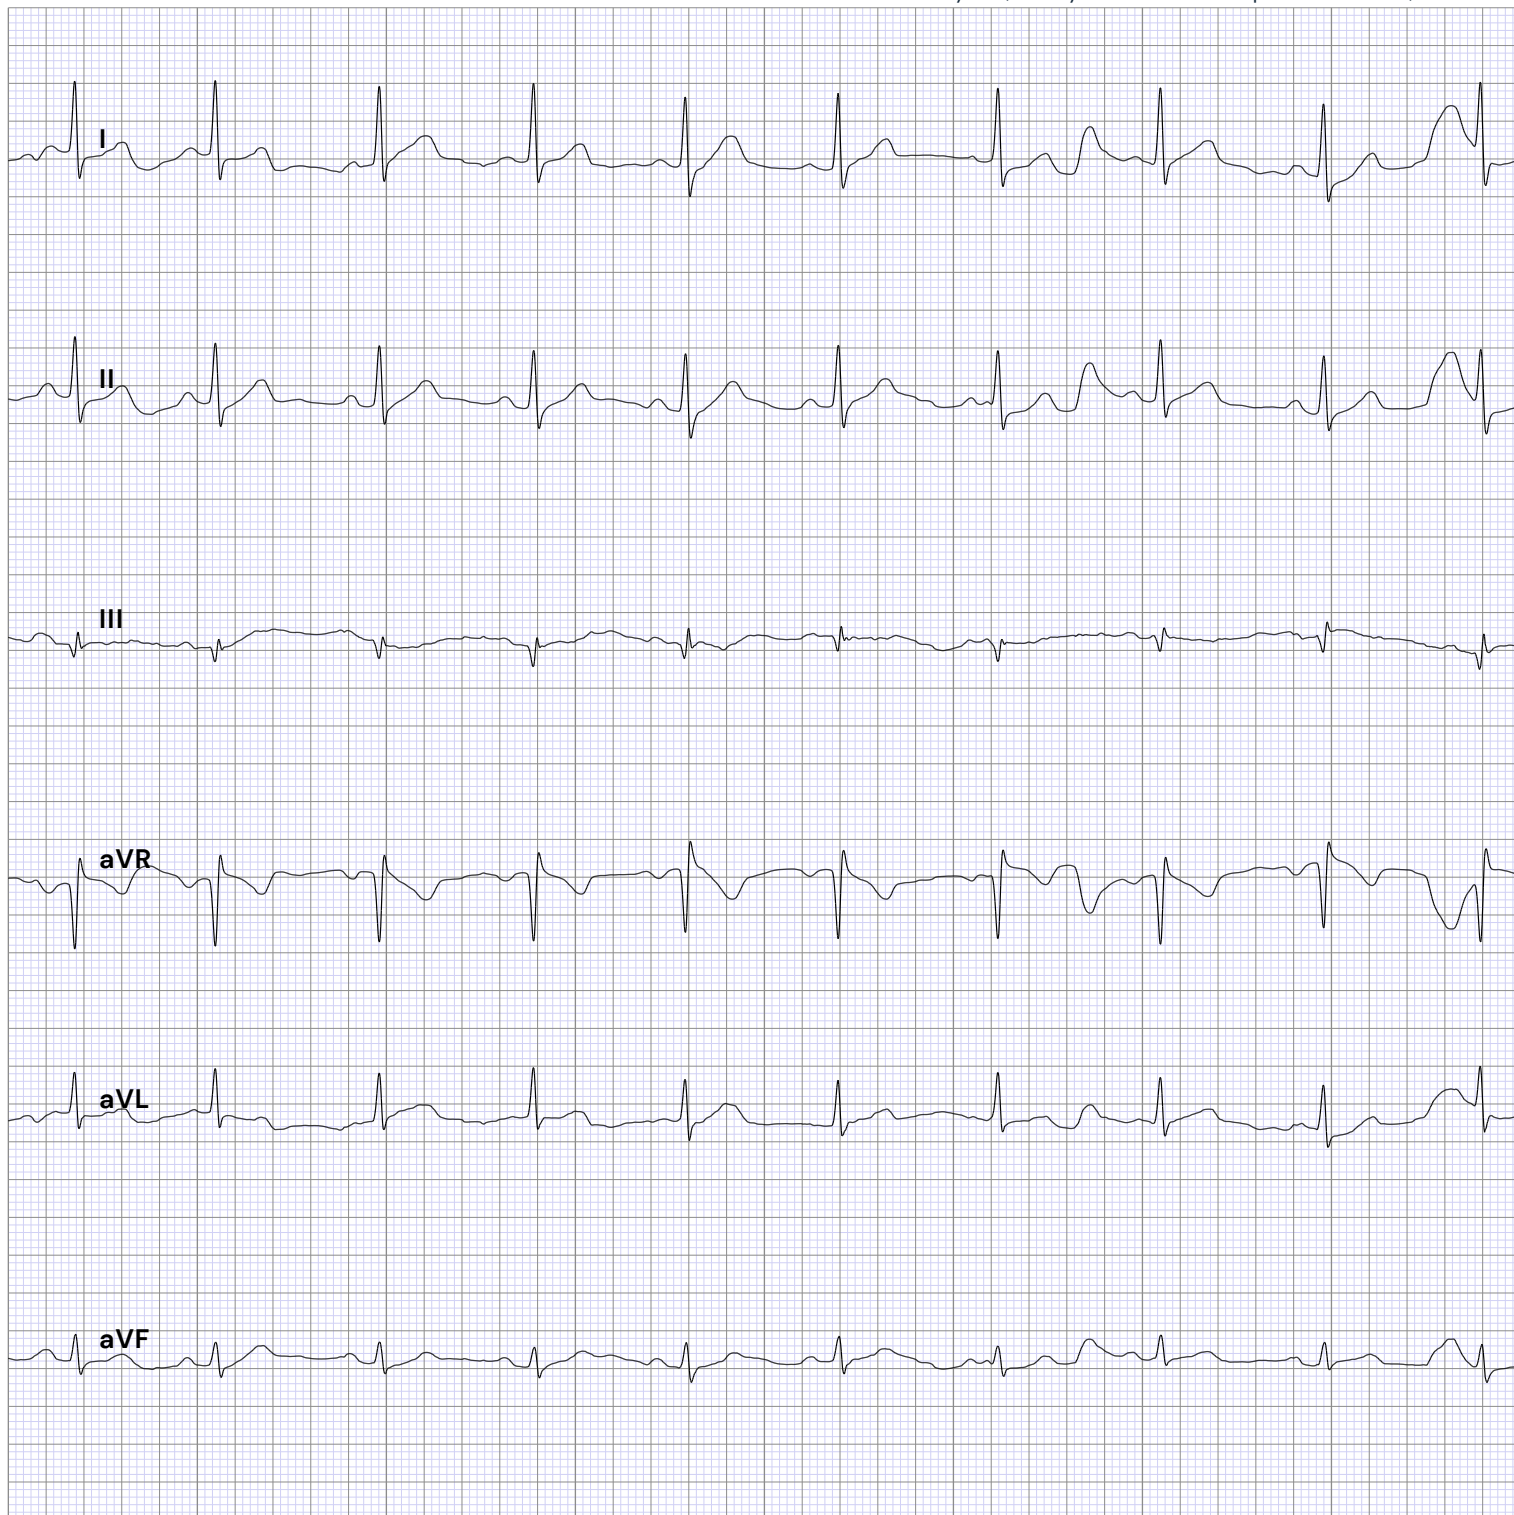

Rozšířený filtr, Síťový filtr: 50 Hz Stupnice: 25mm/s, 10mm/mV

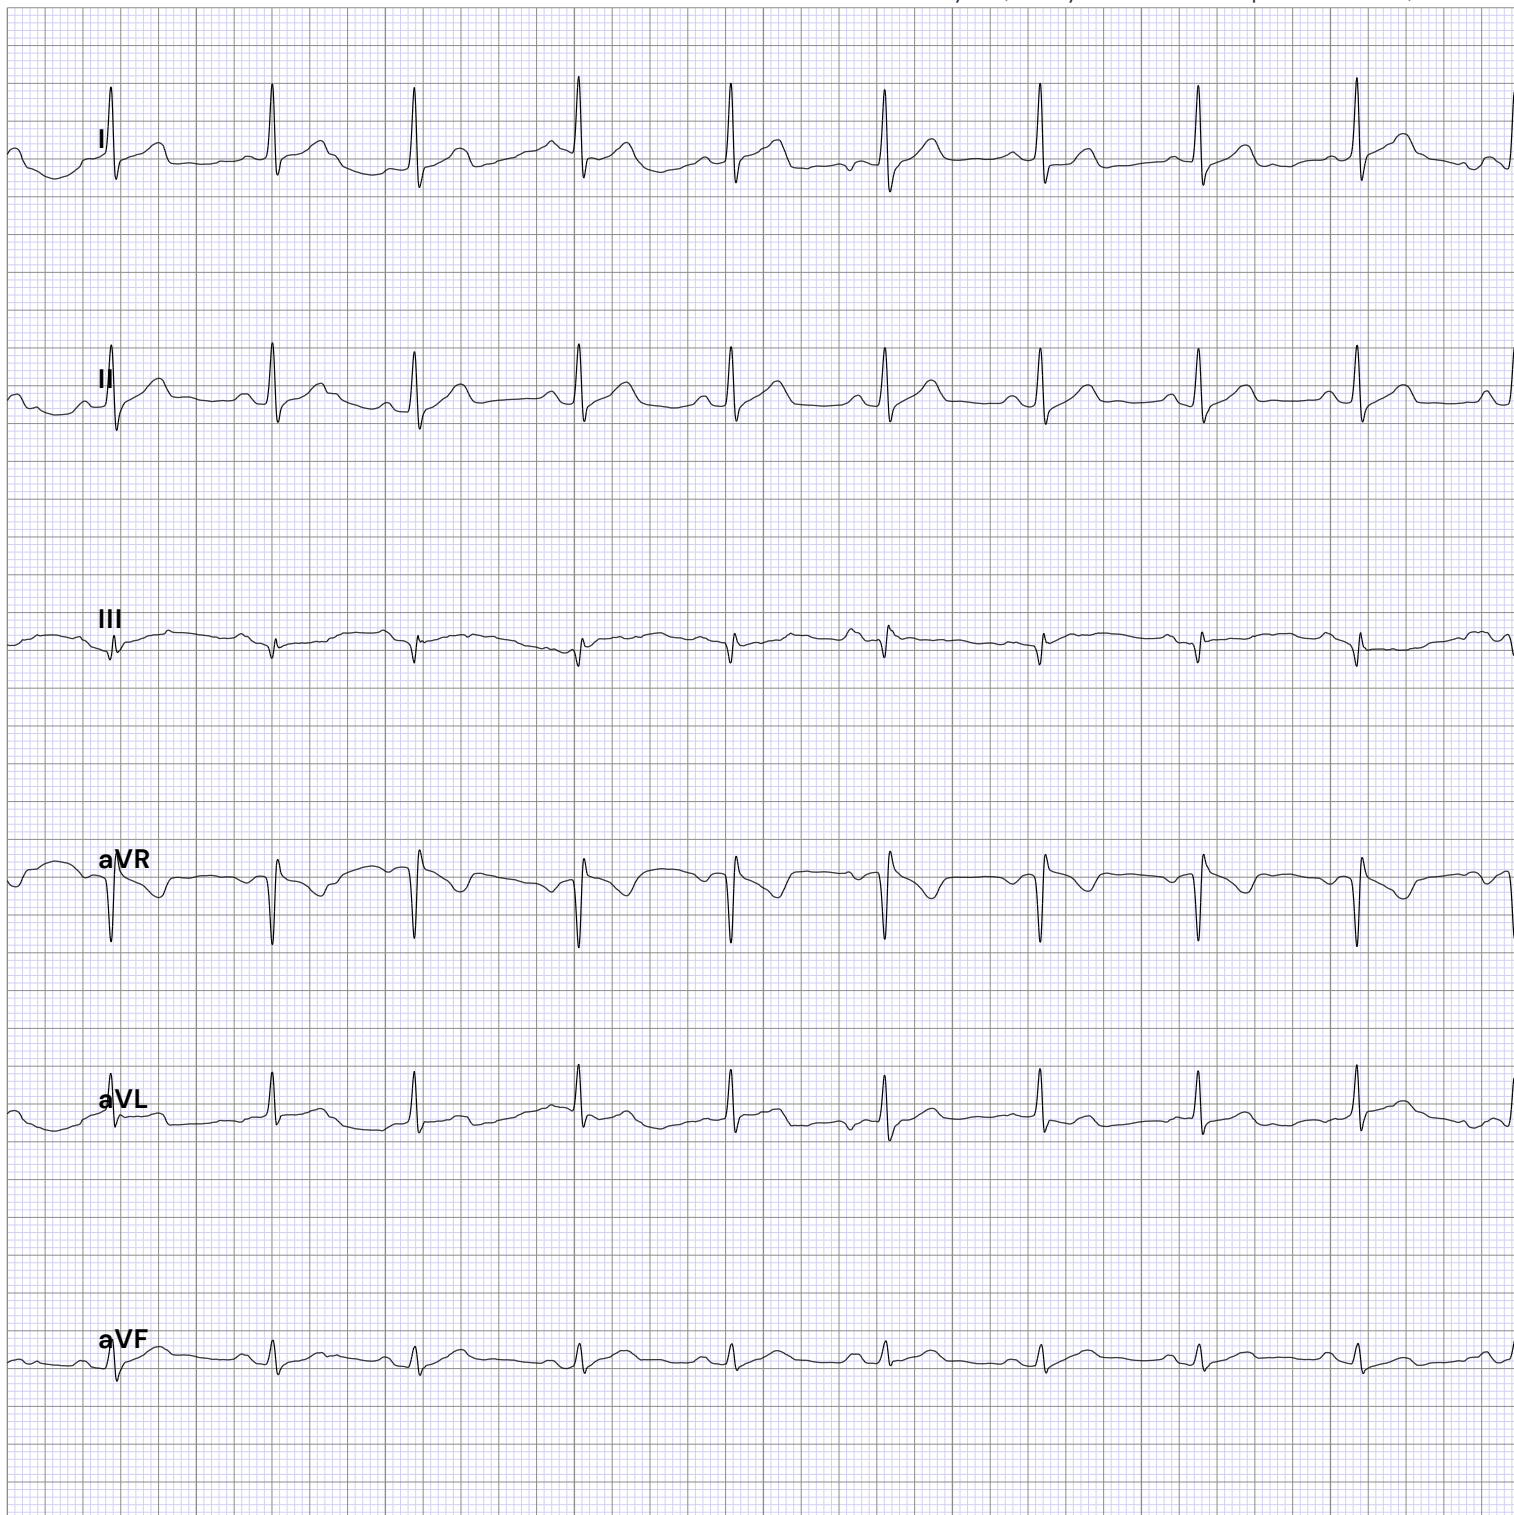

Rozšířený filtr, Síťový filtr: 50 Hz Stupnice: 25mm/s, 10mm/mV

